

תעודת בדיקה מספר 7052354279

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : א. פתיה מוצרים אלקטרו מכניים חברה בע"מ ח.פ. : 510564693
 מענו : אליהו איתן 15 ראשון לציון 75703
 תאריך ההזמנה : 2020/05/25

תאור המוצר

נורות דיודה פולטות אור (LED) - בעלות שתי כיפות נורות פלואורניות
 הדגם הנבדק : FET 92418 נורת LED TUBE T8 : 230V-G13-24W-IP20-6500K
 יצרן : FETAYA LIGHTING
 ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2020/05/13 הנוטל: המזמין
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק: אימות תעודה להכרה

התאמה לסעיפים: של התקן הישראלי ת"י 62776 - נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות, מנובמבר 2015

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

אימות תעודת CB TEST CERTIFICATE No.: DE-6-G6190140
 שהופקה ע"י: Eurofins בתאריך: 26/03/2019
 ראה פירוט בגוף התעודה. MODEL/TYPE:.....
 TEST REPORT REF. No.:.....EF5H18111919-IE-01-L01
 DATE OF ISSUE:.....25/03/2019

2020/06/01

תאריך הפקת תעודה



אברהם גוטמן תפקיד ראש מדור

שם המאשר:

תעודת בדיקה מספר 7052354279

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 5

תאור מודחב של המוצר

תאור: המוצר הנבדק הינו נורת דיודה פולטת אור- LED TUBE T8 בעלת 2 כיפות

שם היצרן- FETAYA LIGHTING, ארץ הייצור- סין

דגמים:



1. FET 92418

Risk group	גוון אור	דרגת הגנה	הספק	בית נורה	מתח
RG0	6500K	IP20	24W	G13	230V

2. FET 92518

Risk group	גוון אור	דרגת הגנה	הספק	בית נורה	מתח
RG0	3000K	IP20	24W	G13	230V




ראה תמונות מצורפות

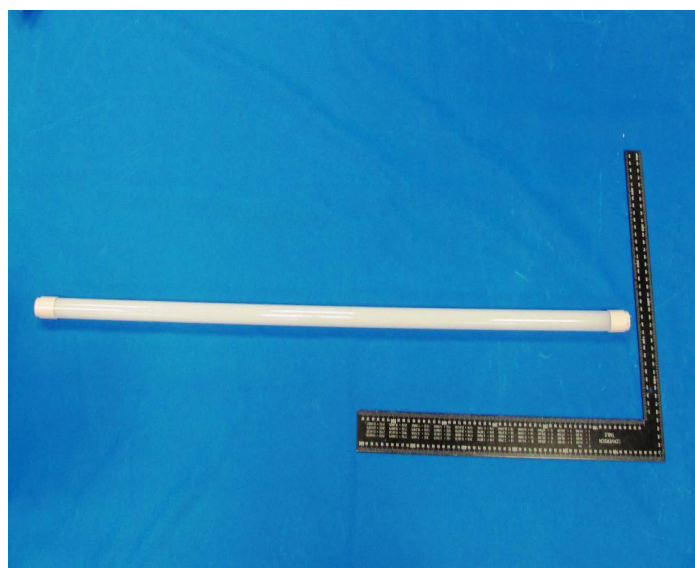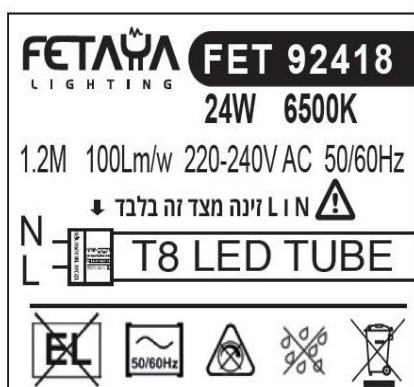

תעודת בדיקה מספר 7052354279

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



דף 3 מתוך 5

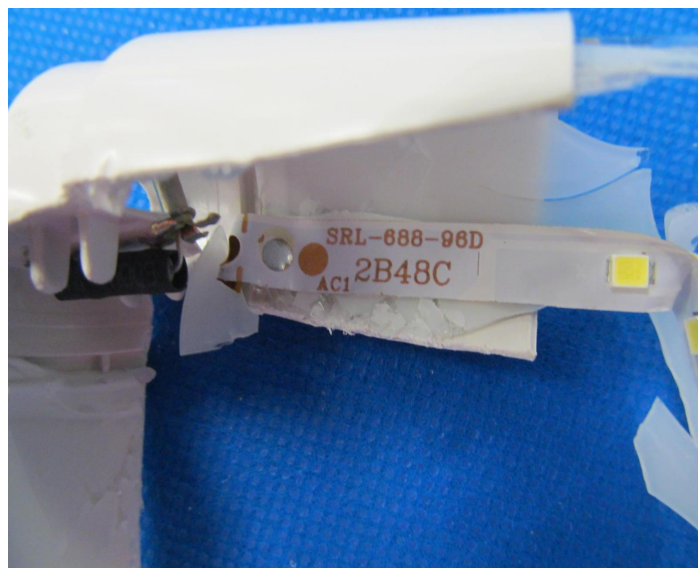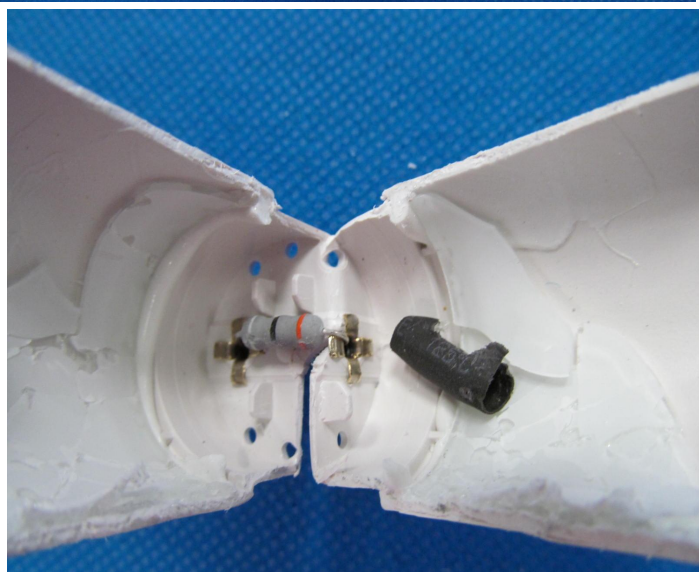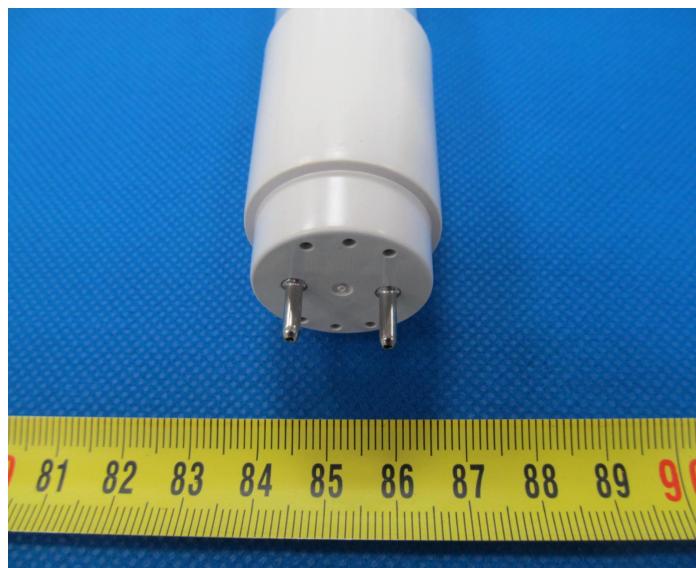

תעודת בדיקה מספר 7052354279

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 5

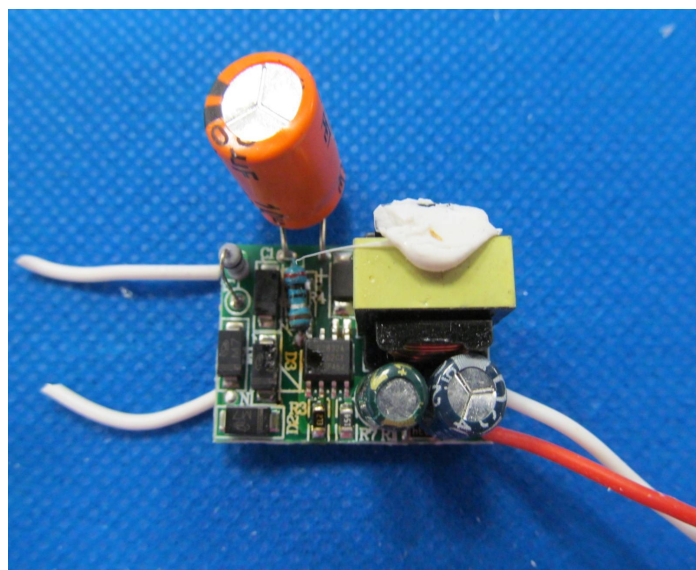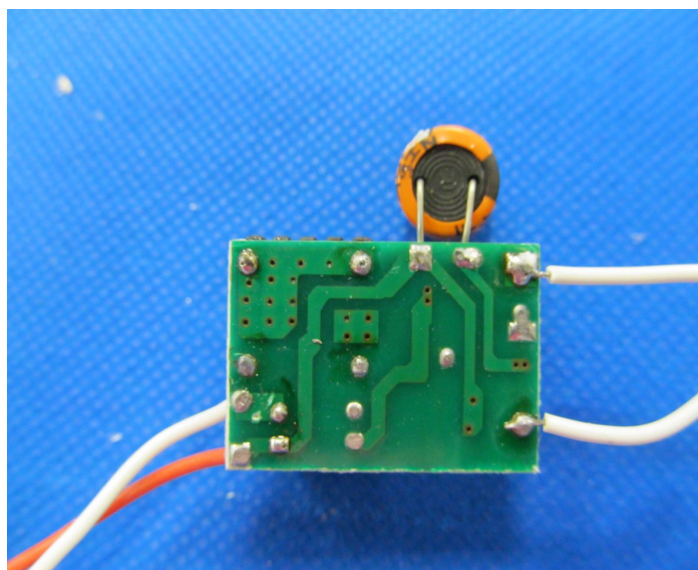

תעודת בדיקה מספר 7052354279

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 5 מתוך 5

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
5	סימון		מתאים
8	הגנה מפני מגע מקרי בחלקים חיים		מתאים
9	חוזק מכני של הכיפות		מתאים

סוף תעודת הבדיקה